


長野県各地区の耐性菌分離率


対象期間:2014年5月～2014年10月の6ヶ月間

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)

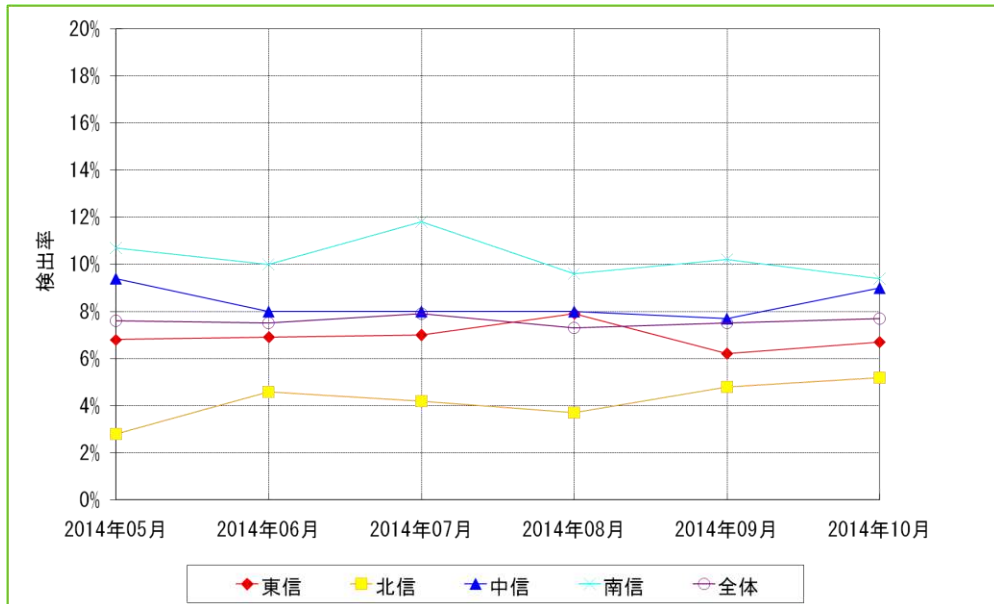

施設名	2014年05月			2014年06月			2014年07月			2014年08月			2014年09月			2014年10月		
	検体総数	検出数	検出率	検体総数	検出数	検出率	検体総数	検出数	検出率	検体総数	検出数	検出率	検体総数	検出数	検出率	検体総数	検出数	検出率
東信 計	556	38	6.8%	569	39	6.9%	586	41	7.0%	582	46	7.9%	581	36	6.2%	583	39	6.7%
北信 計	1126	32	2.8%	1070	49	4.6%	1179	49	4.2%	1154	43	3.7%	1083	52	4.8%	1201	62	5.2%
中信 計	1189	112	9.4%	1178	94	8.0%	1219	98	8.0%	1224	98	8.0%	1173	90	7.7%	1105	100	9.0%
南信 計	1247	133	10.7%	1204	121	10.0%	1261	149	11.8%	1235	118	9.6%	1269	129	10.2%	1270	120	9.4%
全体 計	4118	315	7.6%	4021	303	7.5%	4245	337	7.9%	4195	305	7.3%	4106	307	7.5%	4159	321	7.7%

多剤耐性緑膿菌(MDRP)

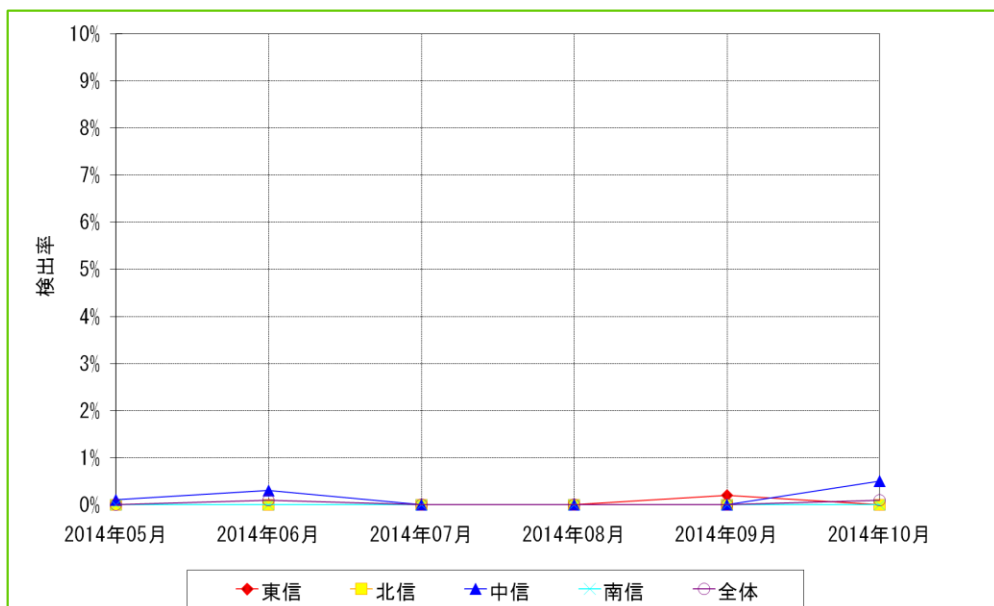


施設名	2014年05月			2014年06月			2014年07月			2014年08月			2014年09月			2014年10月		
	検体総数	検出数	検出率	検体総数	検出数	検出率	検体総数	検出数	検出率	検体総数	検出数	検出率	検体総数	検出数	検出率	検体総数	検出数	検出率
東信 計	556	0	0.0%	569	0	0.0%	586	0	0.0%	582	0	0.0%	581	1	0.2%	583	0	0.0%
北信 計	1126	0	0.0%	1070	0	0.0%	1179	0	0.0%	1154	0	0.0%	1083	0	0.0%	1201	0	0.0%
中信 計	1189	1	0.1%	1178	4	0.3%	1219	0	0.0%	1224	0	0.0%	1173	0	0.0%	1105	5	0.5%
南信 計	1247	0	0.0%	1204	0	0.0%	1261	0	0.0%	1235	0	0.0%	1269	0	0.0%	1270	0	0.0%
全体 計	4118	1	0.0%	4021	4	0.1%	4245	0	0.0%	4195	0	0.0%	4106	1	0.0%	4159	5	0.1%

長野県各地区の耐性菌分離率

対象期間: 2014年5月～2014年10月の6ヶ月間

第3世代セファロスポリン耐性大腸菌

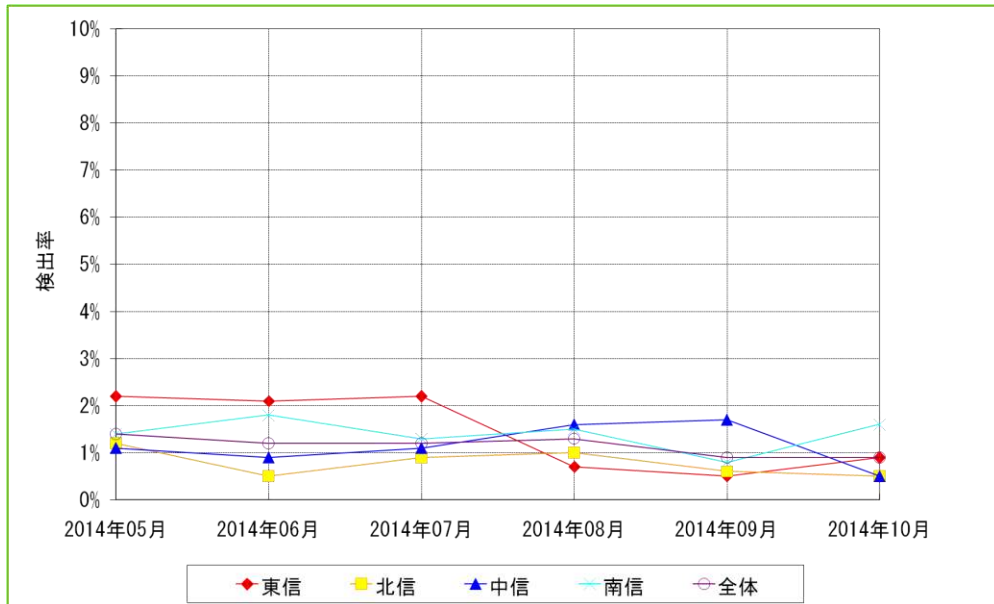

施設名	2014年05月			2014年06月			2014年07月			2014年08月			2014年09月			2014年10月		
	検体総数	検出数	検出率	検体総数	検出数	検出率	検体総数	検出数	検出率	検体総数	検出数	検出率	検体総数	検出数	検出率	検体総数	検出数	検出率
東信 計	556	12	2.2%	569	12	2.1%	586	13	2.2%	582	4	0.7%	581	3	0.5%	583	5	0.9%
北信 計	1126	14	1.2%	1070	5	0.5%	1179	11	0.9%	1154	11	1.0%	1083	6	0.6%	1201	6	0.5%
中信 計	1189	13	1.1%	1178	11	0.9%	1219	13	1.1%	1224	20	1.6%	1173	20	1.7%	1105	5	0.5%
南信 計	1247	18	1.4%	1204	22	1.8%	1261	16	1.3%	1235	19	1.5%	1269	10	0.8%	1270	20	1.6%
全体 計	4118	57	1.4%	4021	50	1.2%	4245	53	1.2%	4195	54	1.3%	4106	39	0.9%	4159	36	0.9%

抽出条件・統計処理

- ・対象期間の入院患者を対象とする。
- ・重複処理は患者IDが同じ場合1件とカウントする。
- ・耐性菌の分離率=[(菌分離患者数)÷(検体提出患者数)]×100(%)

信州インфекションコントロールサーベイランスシステム(SICSS) 耐性菌判定基準

菌名	概要	微量液体希釈法	ディスク拡散法
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA)	MPIPCが“R”の <i>Staphylococcus aureus</i> (又はCFXがディスク拡散法で“R”)、又は選択培地でMRSAと確認された菌	MPIPC ≥ 4μg/mL	MPIPC ≤ 10mm CFX ≤ 21mm
多剤耐性緑膿菌 (MDRP)	下記条件をすべて満たす <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ・カルバペネム系が“R” ・アミノグリコシド系はAMKが微量液体希釈法で耐性、又はディスク拡散法で“R” ・フルオロキノロン系が“R” (LVFX、CPFXのいずれか)	IPM・MEPM ≥ 16μg/mL AMK ≥ 32μg/mL LVFX ≥ 8μg/mL CPFX ≥ 4μg/mL	IPM、MEPM ≤ 13mm AMK ≤ 14mm LVFX ≤ 13mm CPFX ≤ 15mm
第3世代セファロスポリン耐性大腸菌	CTXが“I”か“R”、又はCAZが“R”の <i>Escherichia coli</i>	CTX ≥ 16μg/mL CAZ ≥ 32μg/mL	CTX ≤ 22mm CAZ ≤ 14mm